Реагенты в лабораторных исследованиях

Для того, чтобы у сотрудников лаборатории была возможность указывать реагенты и тест-системы, при помощи которых были проведены исследования, необходимо настроить соответствие реагентов и исследований.

Привязка реагентов к анализу

Для привязки реагентов к анализу перейдите в справочник лабораторных исследований. (Справочники – Лаборатория – Исследования – Исследования лаборатории) (Рисунок 1).

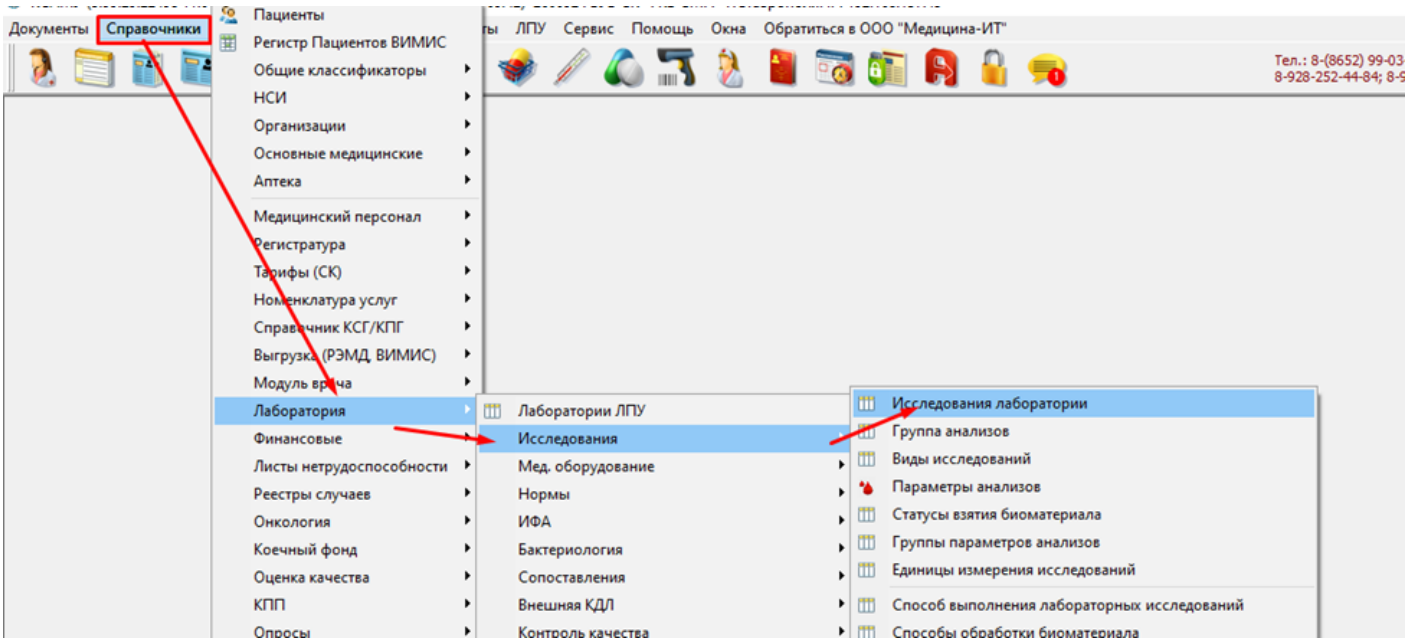


Рисунок 1

В справочнике найдите нужный анализ и откройте его двойным кликом левой кнопкой мыши. (Рисунок 2)

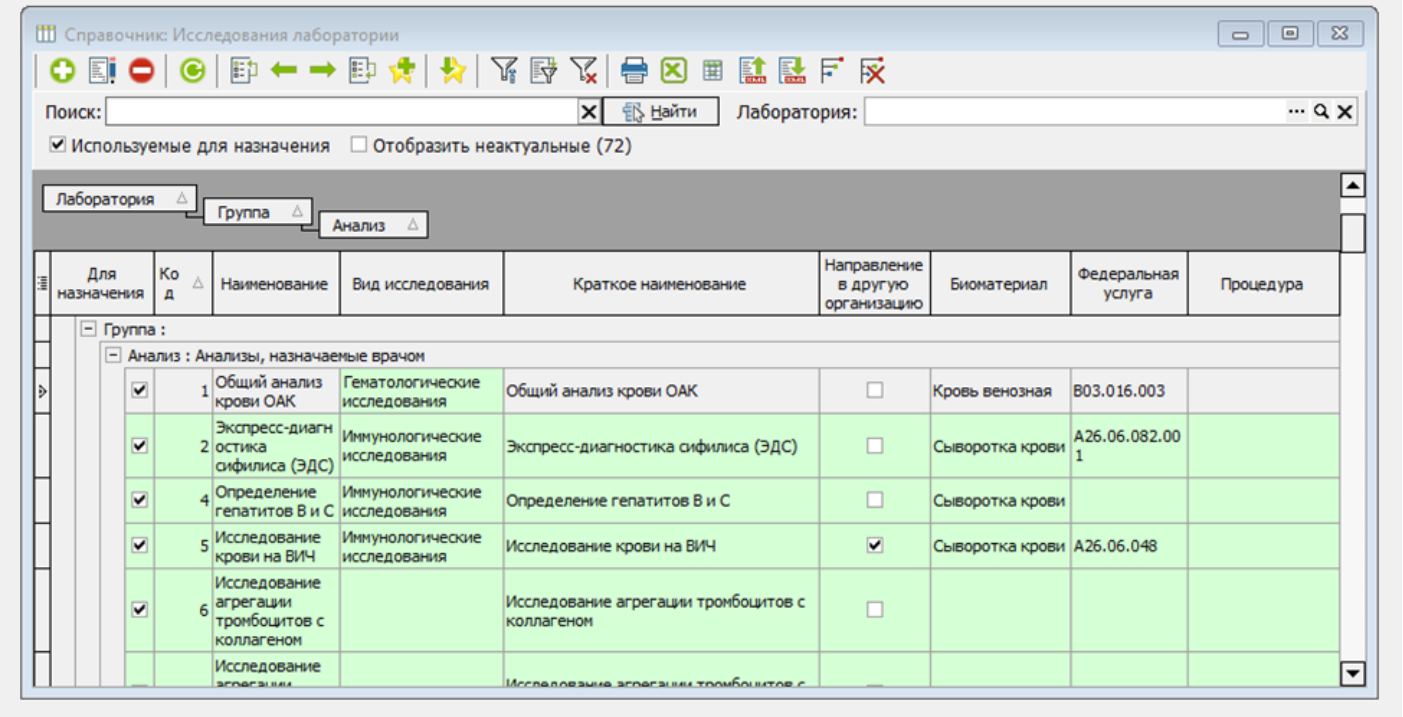


Рисунок 2

В анализе перейдите во вкладку “Реагенты” (Рисунок 3).

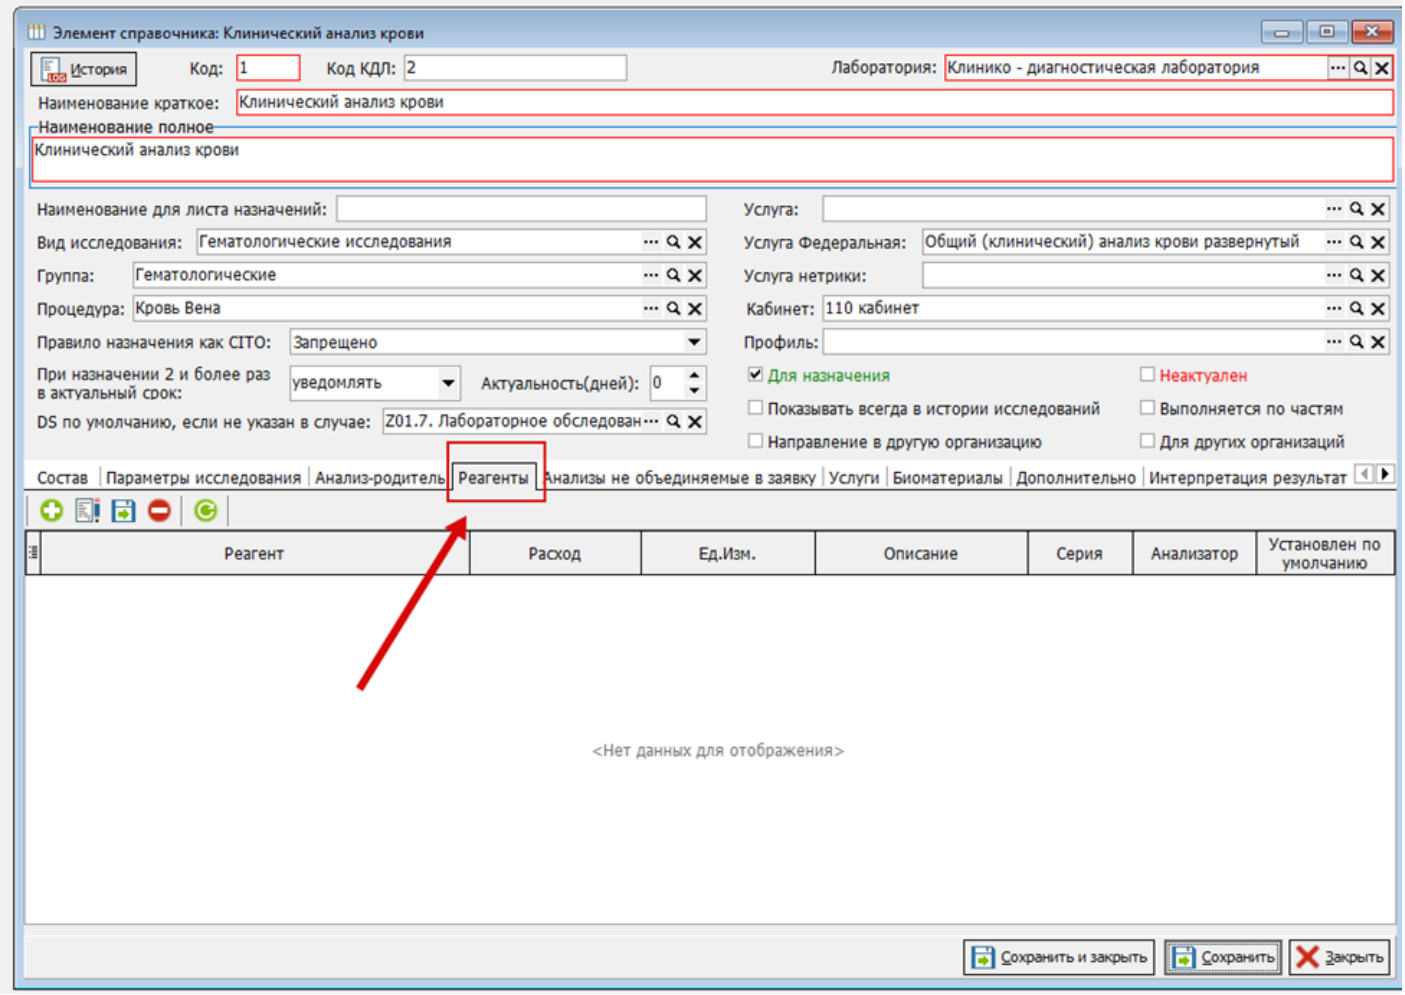


Рисунок 3

Чтобы добавить реагент, необходимо нажать на плюс (Рисунок 4).

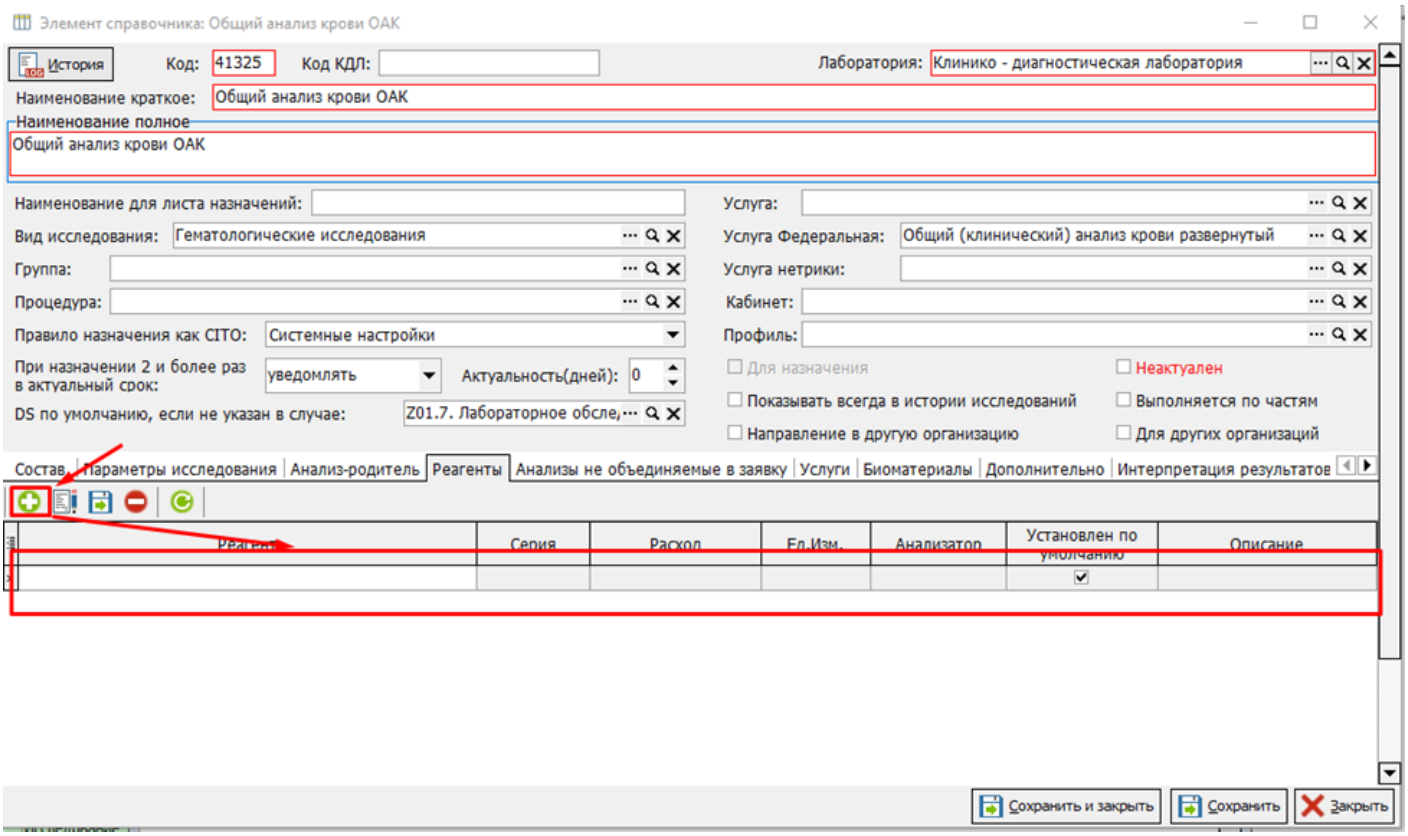


Рисунок 4

Далее, чтобы выбрать реагент, выделите строчку под столбцом “Реагент” и нажмите на три точки (Рисунок 5).

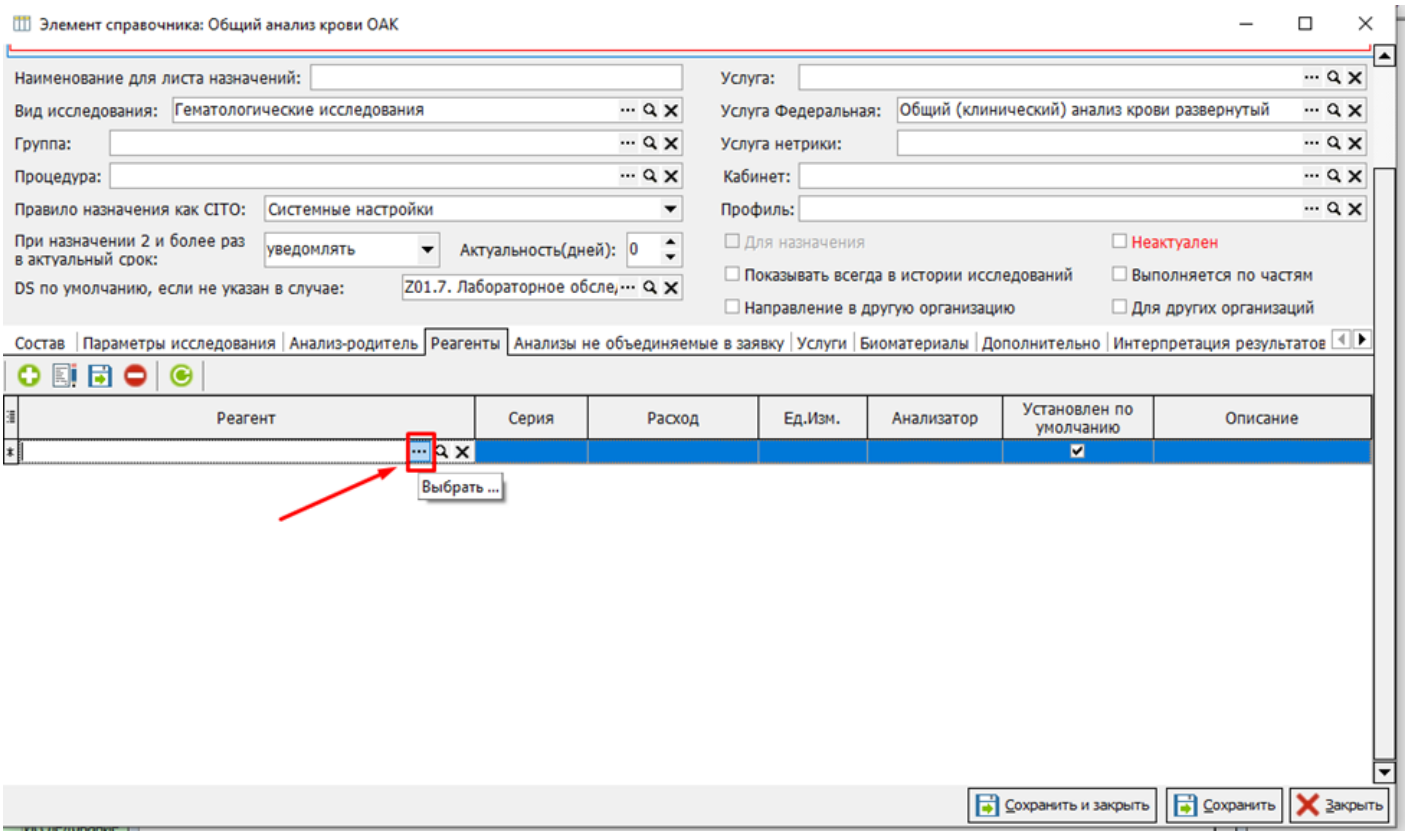


Рисунок 5

Откроется справочник “Номенклатура”, где нужно выбрать нужный реагент. (Рисунок 6)

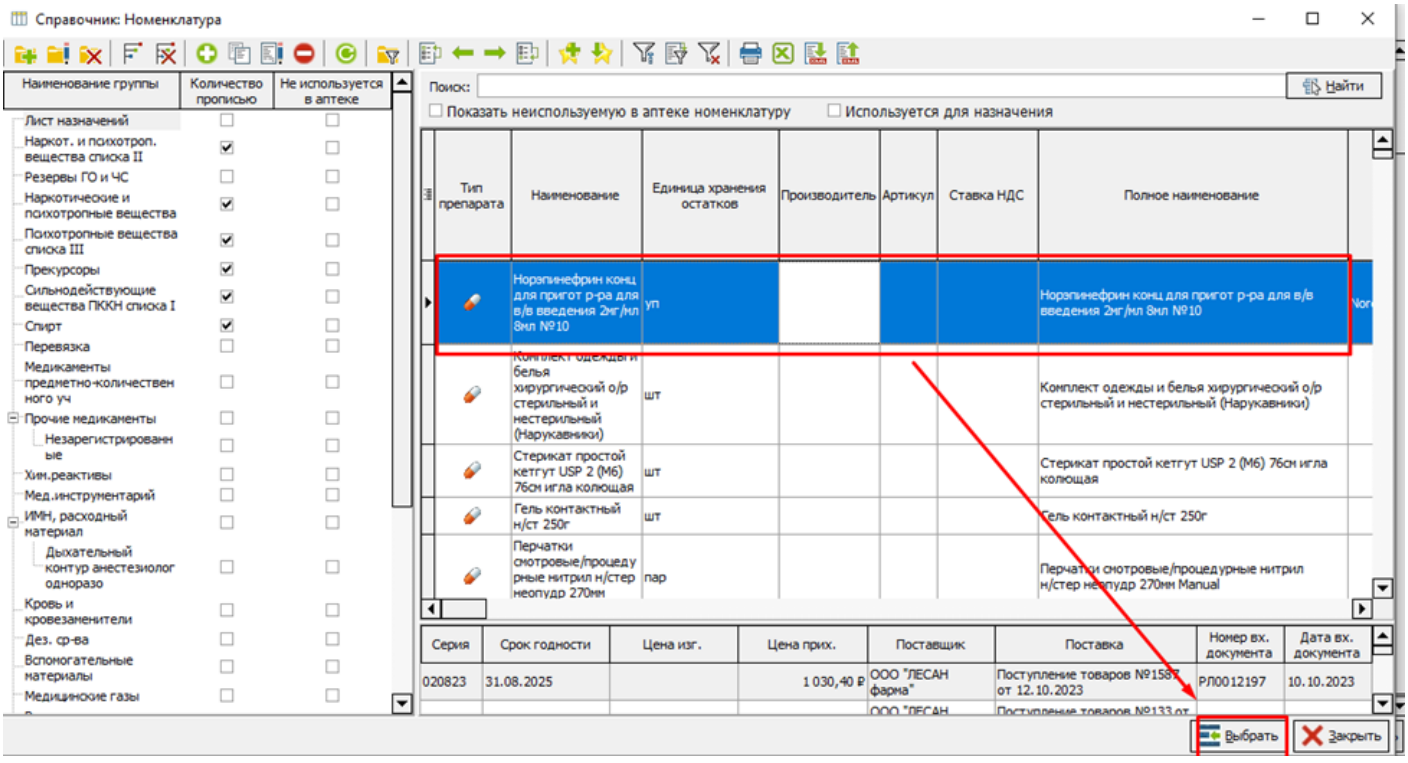


Рисунок 6

В строке с добавленным реагентом есть другие столбцы, которые можно заполнить при необходимости, такие как: расход (1), ед. изм. (2), описание (3), серия (4) и анализатор (5).

Расход, ед. изм. и описание заполняются для статистики и отчетности. (Рисунок 7)

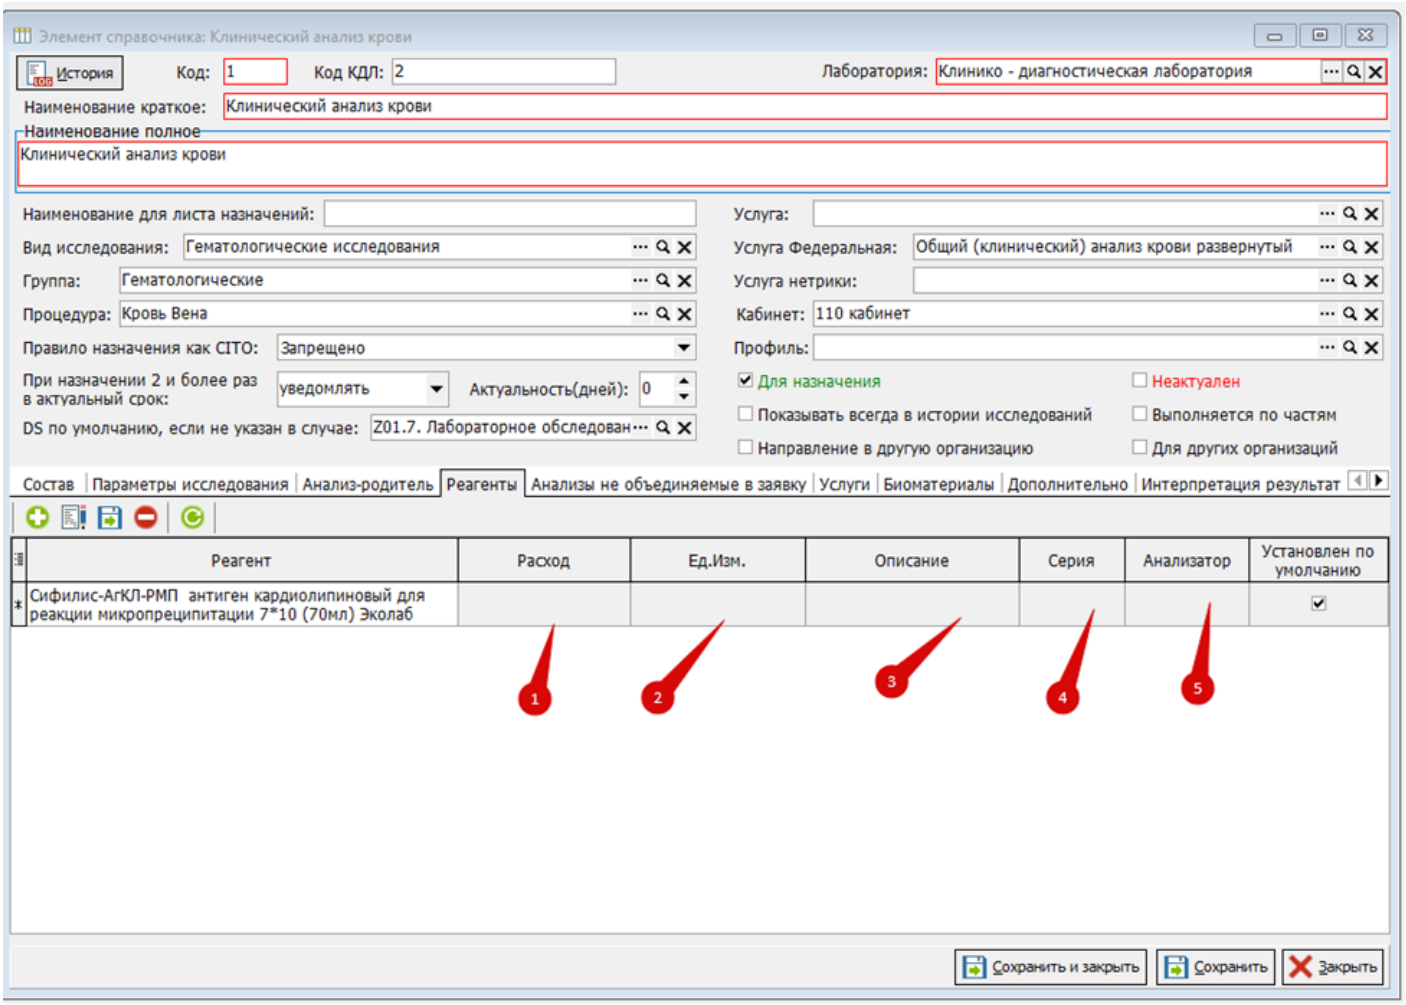
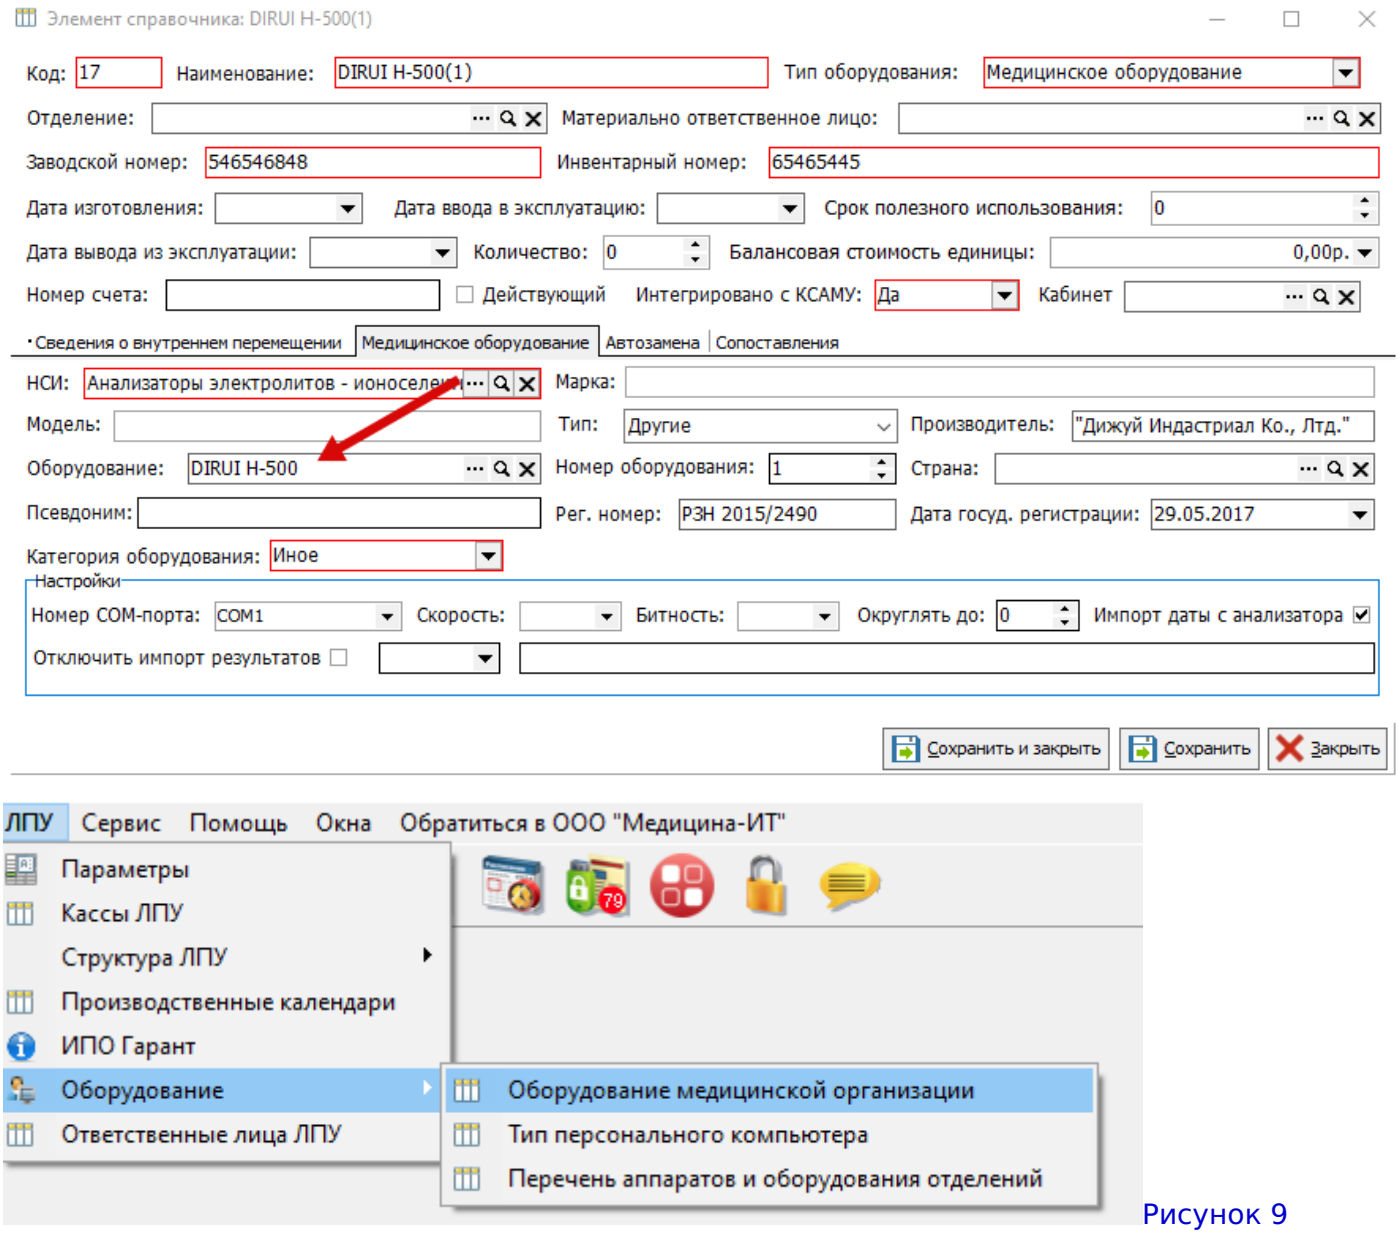


Рисунок 7

Также, если в исследовании поставить галочку в чекбоксе “Установлен по умолчанию”, то реагент, серия и анализатор будет автоматически проставляться в свод и результат. (Рисунок 10-12)
У анализатора обязательно должно быть сопоставление с оборудованием в элементе справочника "Оборудование медицинской организации" (Рисунок 8) (ЛПУ - Оборудование - Оборудование медицинской организации) (рисунок 9).


Элемент справочника: DIRUI H-500(1)
Код: 17
Наименование: DIRUI H-500(1)
Тип оборудования: Медицинское оборудование
Отделение:
Материально ответственное лицо:
Заводской номер: 546546848
Инвентарный номер: 65465445
Дата изготовления:
Дата ввода в эксплуатацию:
Срок полезного использования: 0
Дата вывода из эксплуатации:
Количество: 0
Балансовая стоимость единицы: 0,00р.
Номер счета:
Действующий
Интегрировано с КСАМУ: Да
Кабинет
Сведения о внутреннем перемещении
Медицинское оборудование
Автозамена
Сопоставления
НСИ: Анализаторы электролитов - ионоселек
Марка:
Модель:
Тип: Другие
Производитель: "Дижуй Индастриал Ко., Лтд."
Оборудование: DIRUI H-500
Номер оборудования: 1
Страна:
Псевдоним:
Рег. номер: РЗН 2015/2490
Дата госуд. регистрации: 29.05.2017
Категория оборудования: Иное
Настройки
Номер COM-порта: COM1
Скорость:
Битность:
Округлять до: 0
Импорт даты с анализатора
Отключить импорт результатов
Сохранить и закрыть
Сохранить
Закрыть

ЛПУ
Сервис
Помощь
Окна
Обратиться в ООО "Медицина-ИТ"
Параметры
Кассы ЛПУ
Структура ЛПУ
Производственные календари
ИПО Гарант
Оборудование
Ответственные лица ЛПУ
Оборудование медицинской организации
Тип персонального компьютера
Перечень аппаратов и оборудования отделений

Рисунок 9

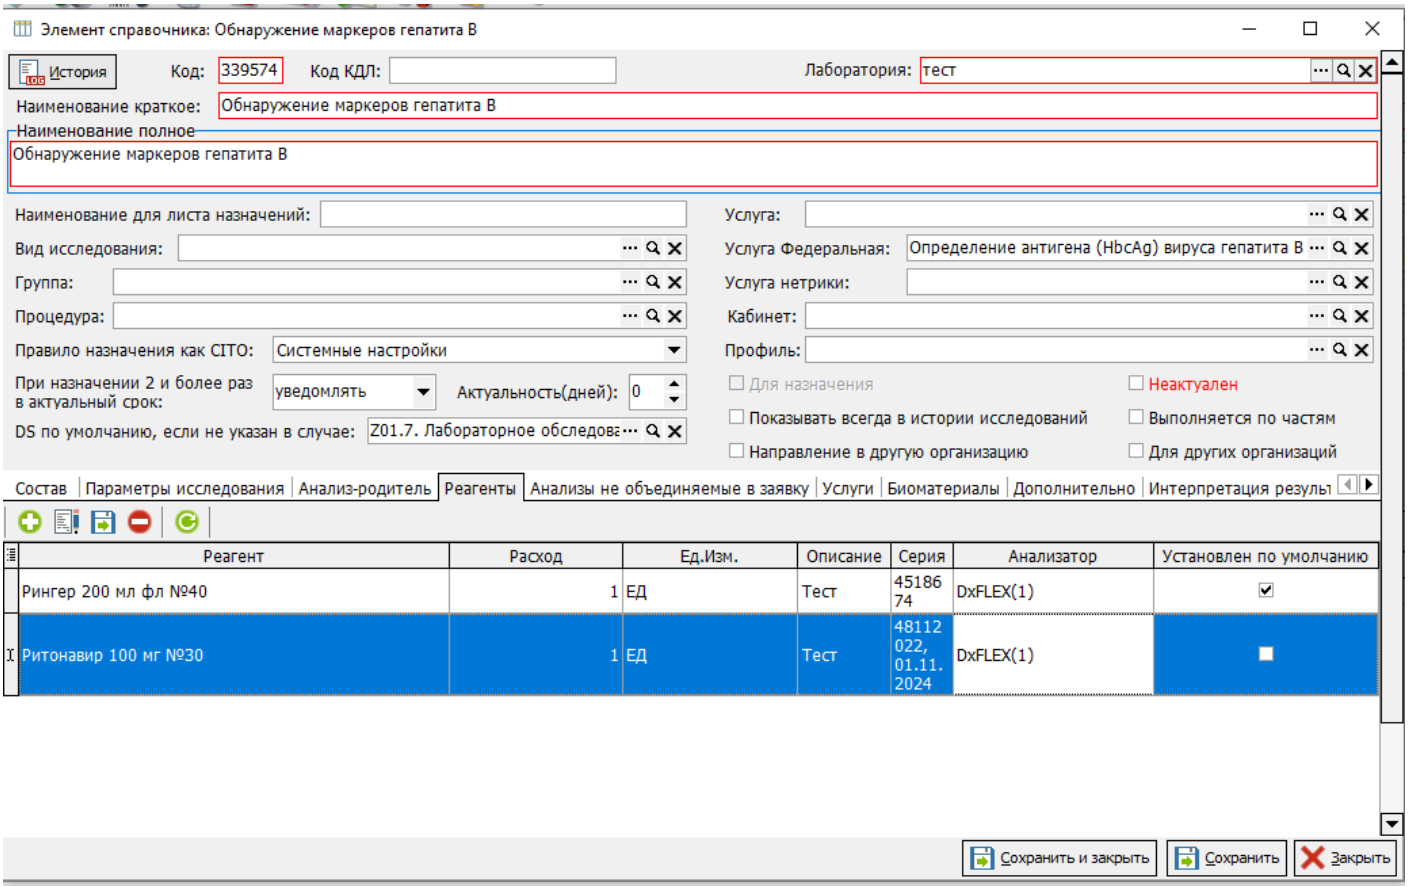

Элемент справочника: Обнаружение маркеров гепатита В
История
Код: 339574
Код КДЛ:
Лаборатория: тест
Наименование краткое: Обнаружение маркеров гепатита В
Наименование полное
Обнаружение маркеров гепатита В
Наименование для листа назначений:
Вид исследования:
Группа:
Процедура:
Правило назначения как CITO: Системные настройки
При назначении 2 и более раз в актуальный срок: уведомлять
Актуальность(дней): 0
DS по умолчанию, если не указан в случае: Z01.7. Лабораторное обследова
Услуга:
Услуга Федеральная: Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита В
Услуга нетрики:
Кабинет:
Профиль:
Для назначения
Неактуален
Показывать всегда в истории исследований
Выполняется по частям
Направление в другую организацию
Для других организаций
Состав
Параметры исследования
Анализ-родитель
Реагенты
Анализы не объединяемые в заявку
Услуги
Биоматериалы
Дополнительно
Интерпретация результ
Реагент
Расход
Ед.Изм.
Описание
Серия
Анализатор
Установлен по умолчанию
Рингер 200 мл фл №40
1
ЕД
Тест
45186 74
DxFLEX(1)
Ритонавир 100 мг №30
1
ЕД
Тест
48112 022, 01.11. 2024
DxFLEX(1)
Сохранить и закрыть
Сохранить
Закрыть

Рисунок 10

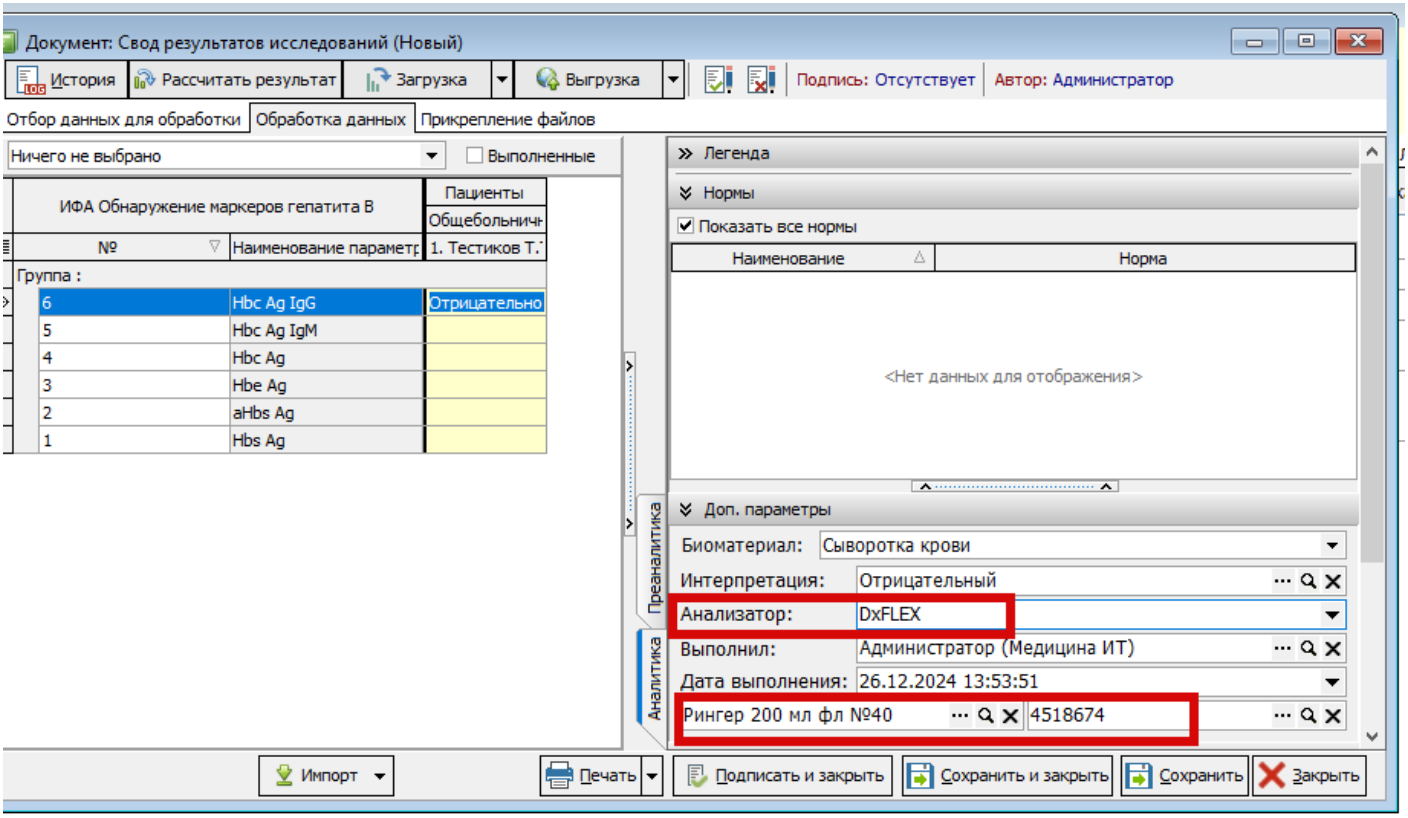

Документ: Свод результатов исследований (Новый)
История
Рассчитать результат
Загрузка
Выгрузка
Подпись: Отсутствует
Автор: Администратор
Отбор данных для обработки
Обработка данных
Прикрепление файлов
Ничего не выбрано
Выполненные
ИФА Обнаружение маркеров гепатита В
Пациенты
№
Наименование параметр
1. Тестиков Т.
Группа :
6 Hbc Ag IgG Отрицательно
5 Hbc Ag IgM
4 Hbc Ag
3 Hbe Ag
2 aHbs Ag
1 Hbs Ag
Легенда
Нормы
Показать все нормы
Наименование
Норма
<Нет данных для отображения>
Доп. параметры
Биоматериал: Сыворотка крови
Интерпретация: Отрицательный
Анализатор: DxFLEX
Выполнил: Администратор (Медицина ИТ)
Дата выполнения: 26.12.2024 13:53:51
Ринжер 200 мл фл №40
4518674
Преаналитика
Аналитика
Импорт
Печать
Подписать и закрыть
Сохранить и закрыть
Сохранить
Закрыть

Рисунок 11

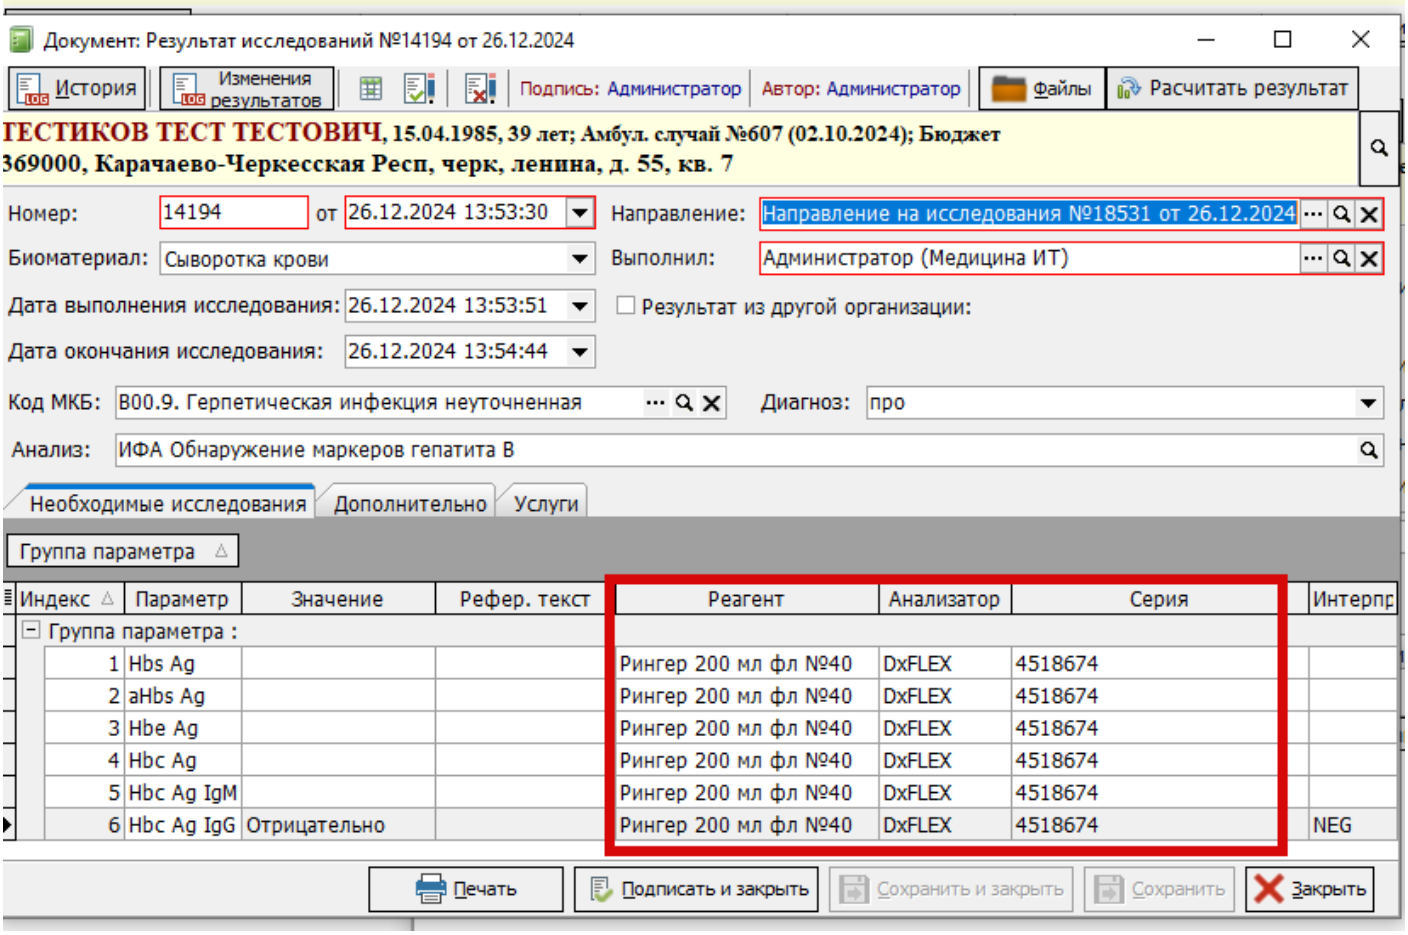


Рисунок 12

После добавления реагента сохраните и закройте анализ. (Рисунок 13)

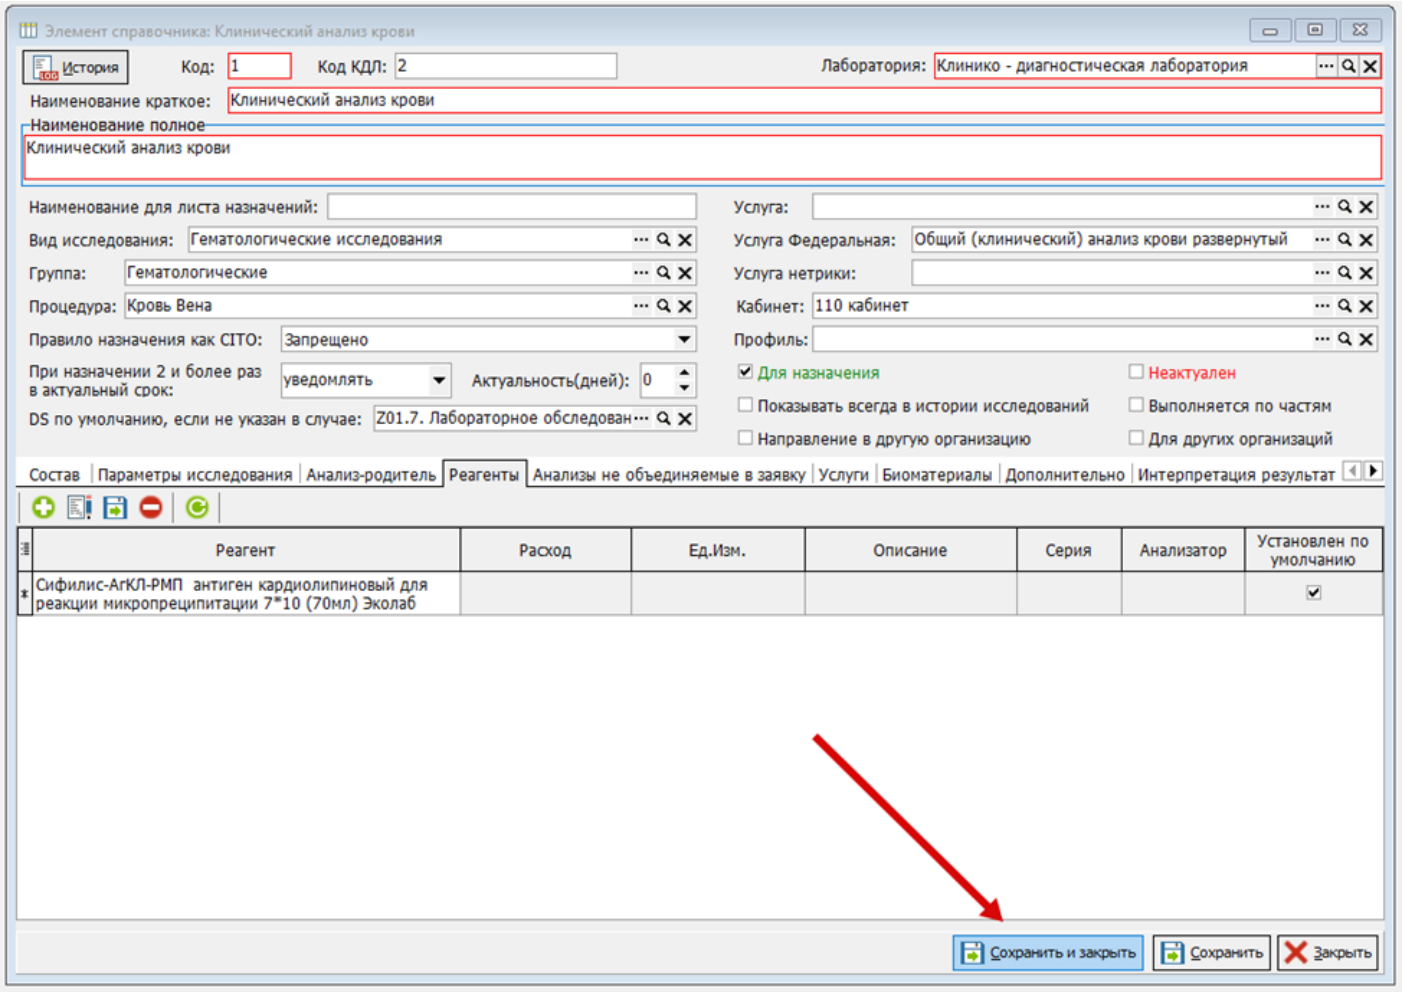


Рисунок 13

Реагенты можно добавить в табличную часть анализа или исследования.

Если реагенты добавить в анализ, то они будут у всех исследований данного анализа.

Если реагенты добавить в исследование, то они будут только у исследования, в которое добавили реагенты.

Работа реагентов в своде/результате

Чтобы заполнить реагент у параметра в своде, необходимо выделить нужный параметр.

В таблице свода найдите строку “Реагент”. (Рисунок 14)

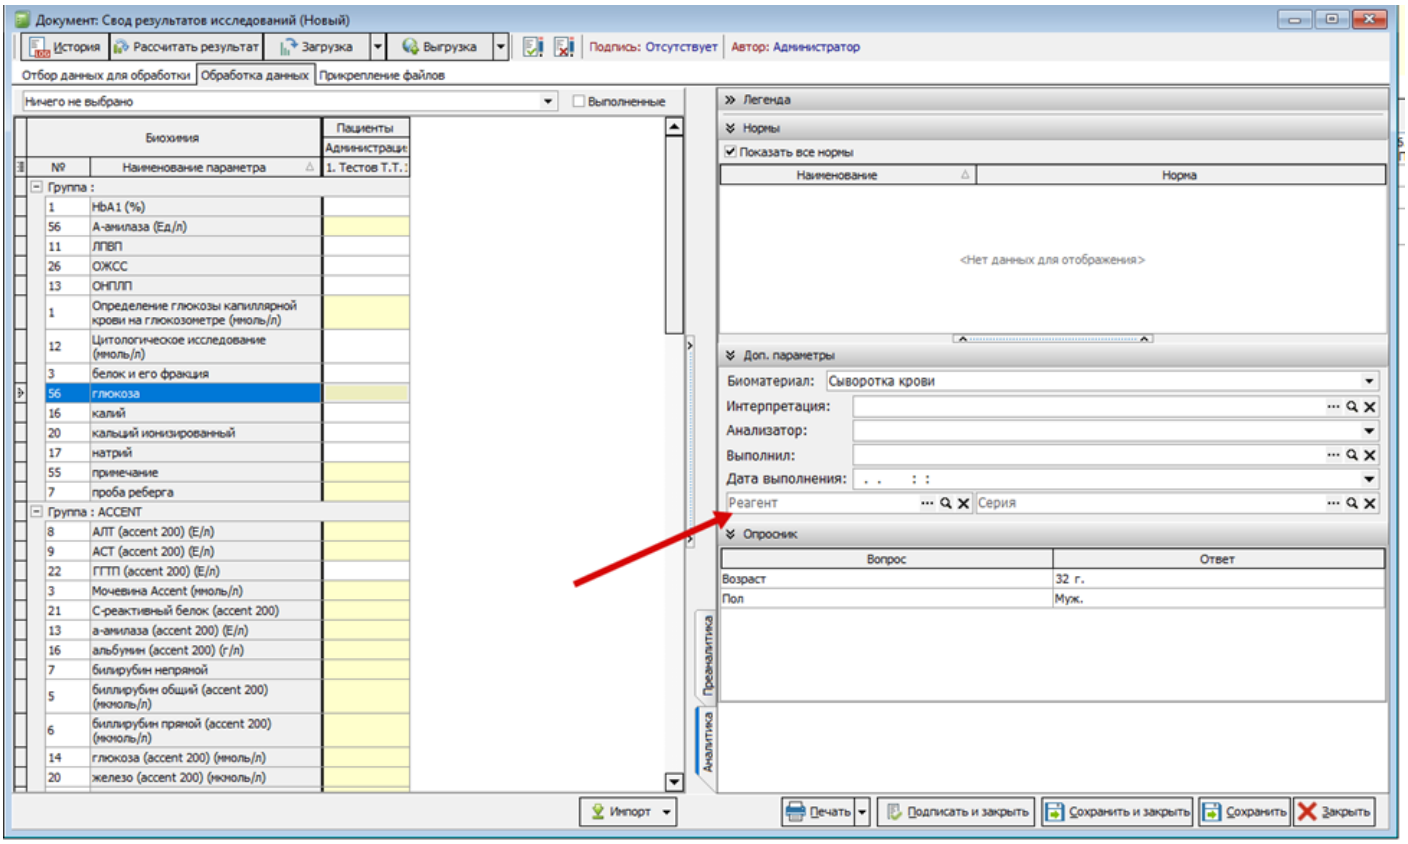


Рисунок 14

Найдите нужный реагент в справочнике, нажав на три точки. (Рисунок 15)

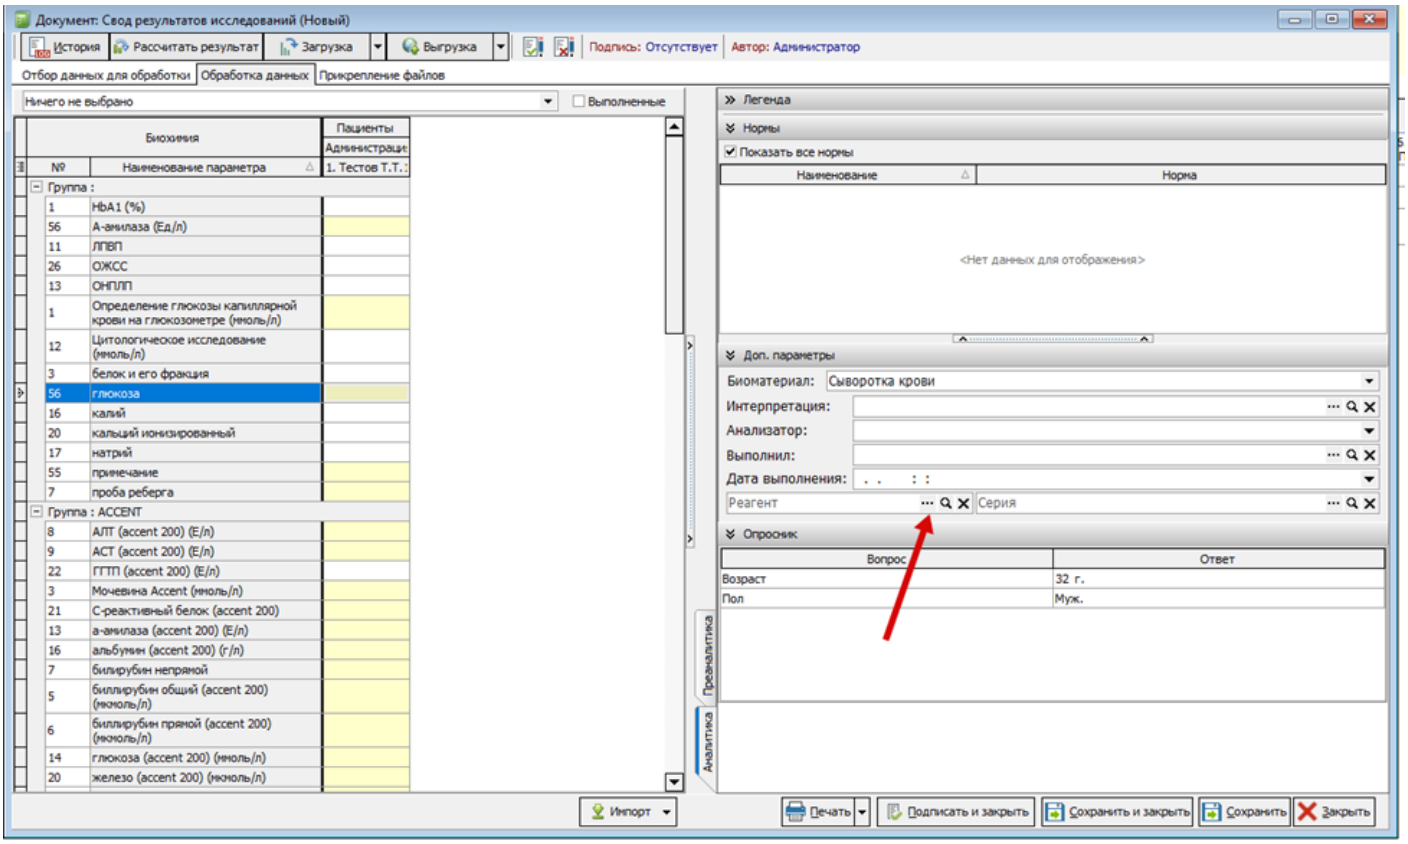


Рисунок 15

В справочнике “Номенклатура” выберете реагент и нажмите на кнопку “Выбрать”. (Рисунок 16)

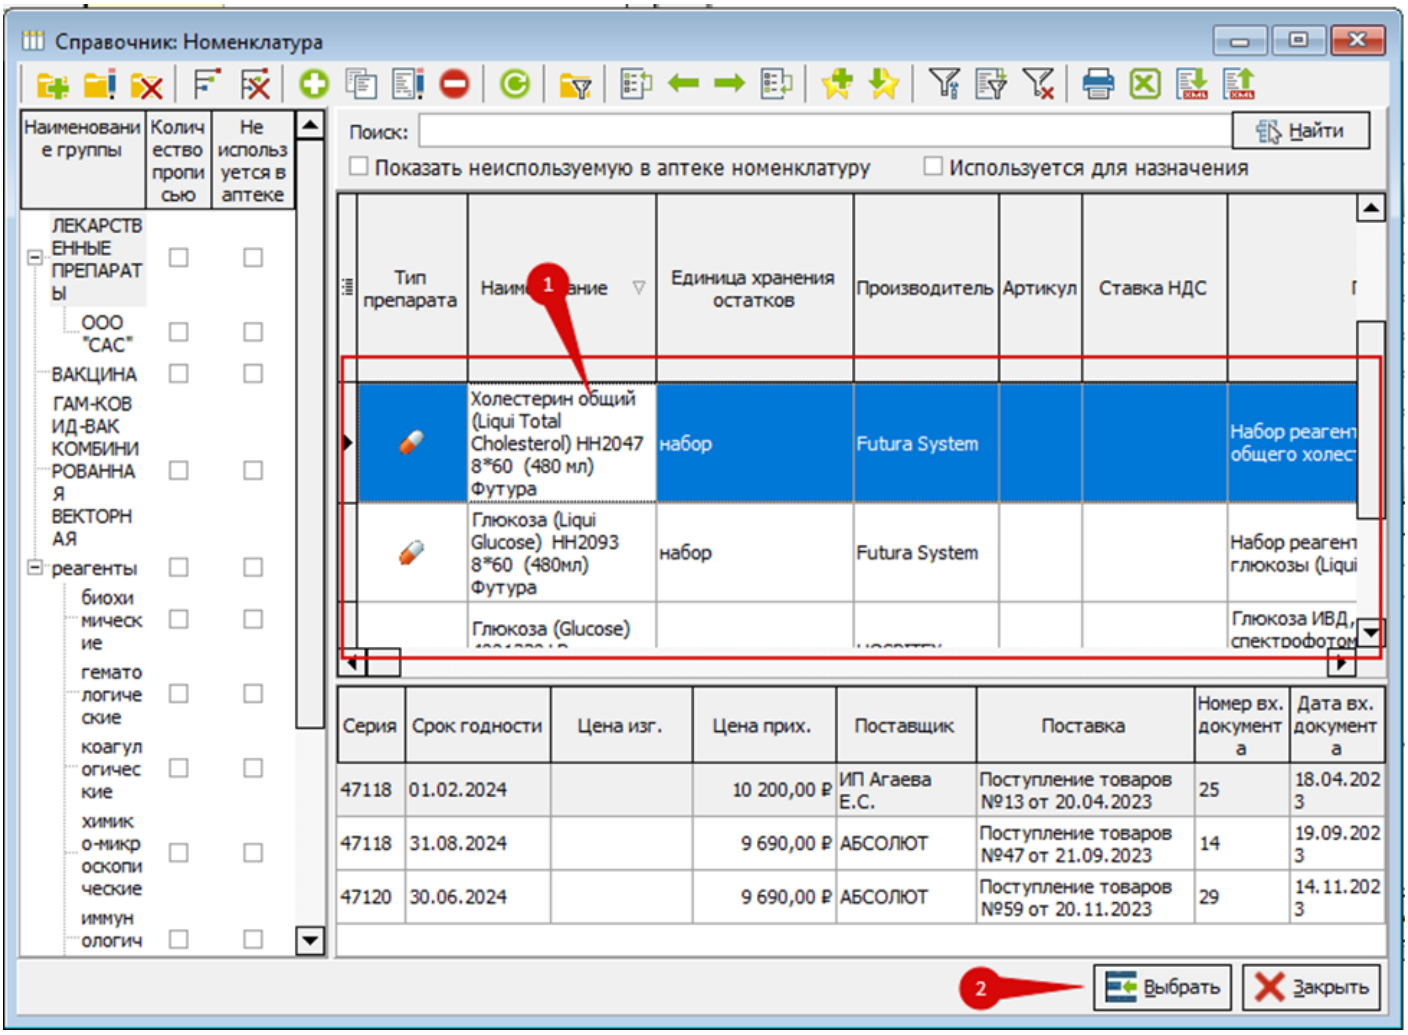


Рисунок 16

Также, чтобы проще было заполнить реагент, напишите код Номенклатуры в строку “Реагент” и нажмите “Enter”. (Рисунок 17)

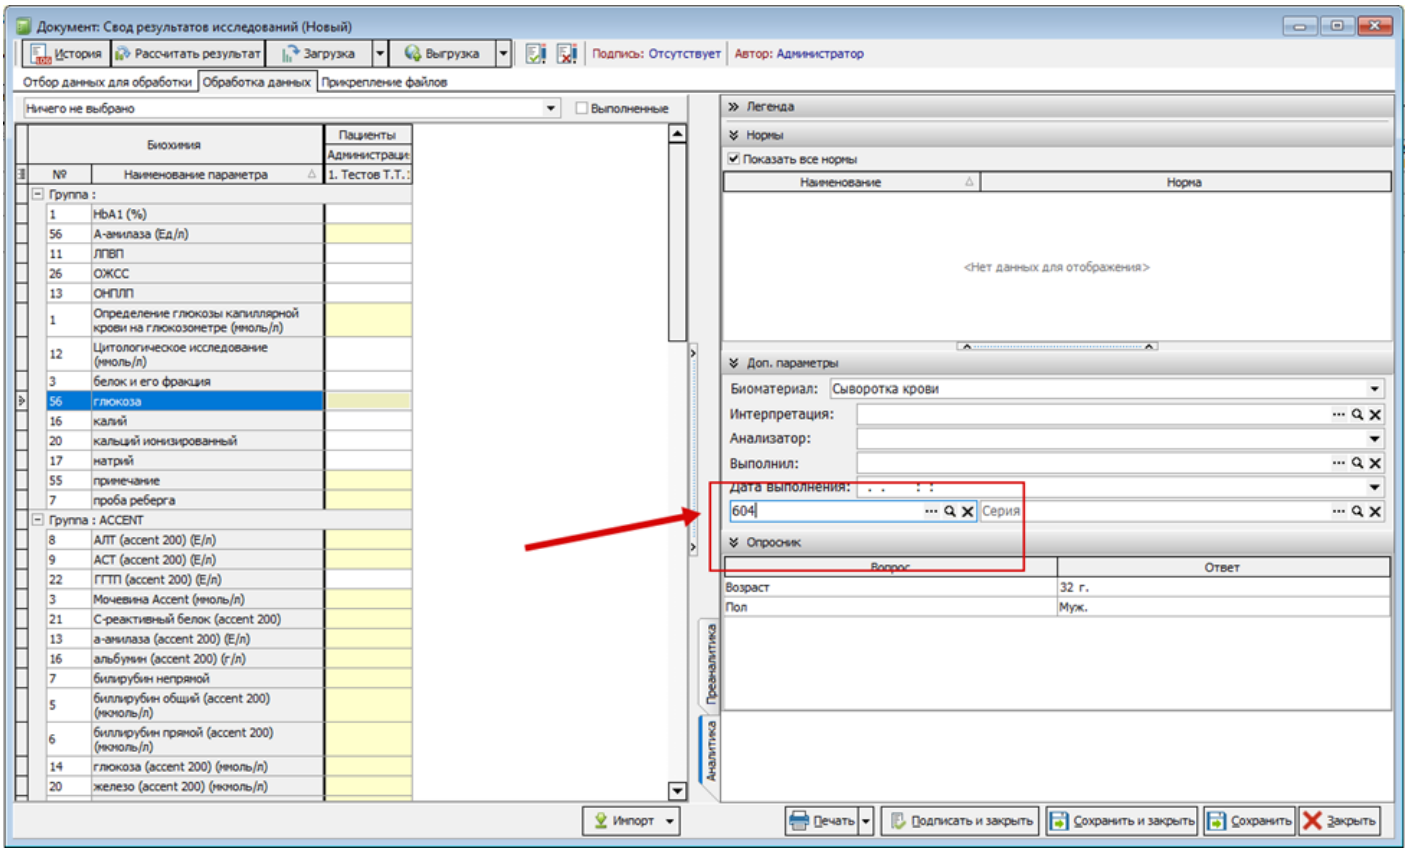


Рисунок 17

Серия реагента заполняется идентичным способом. (Рисунок 18)

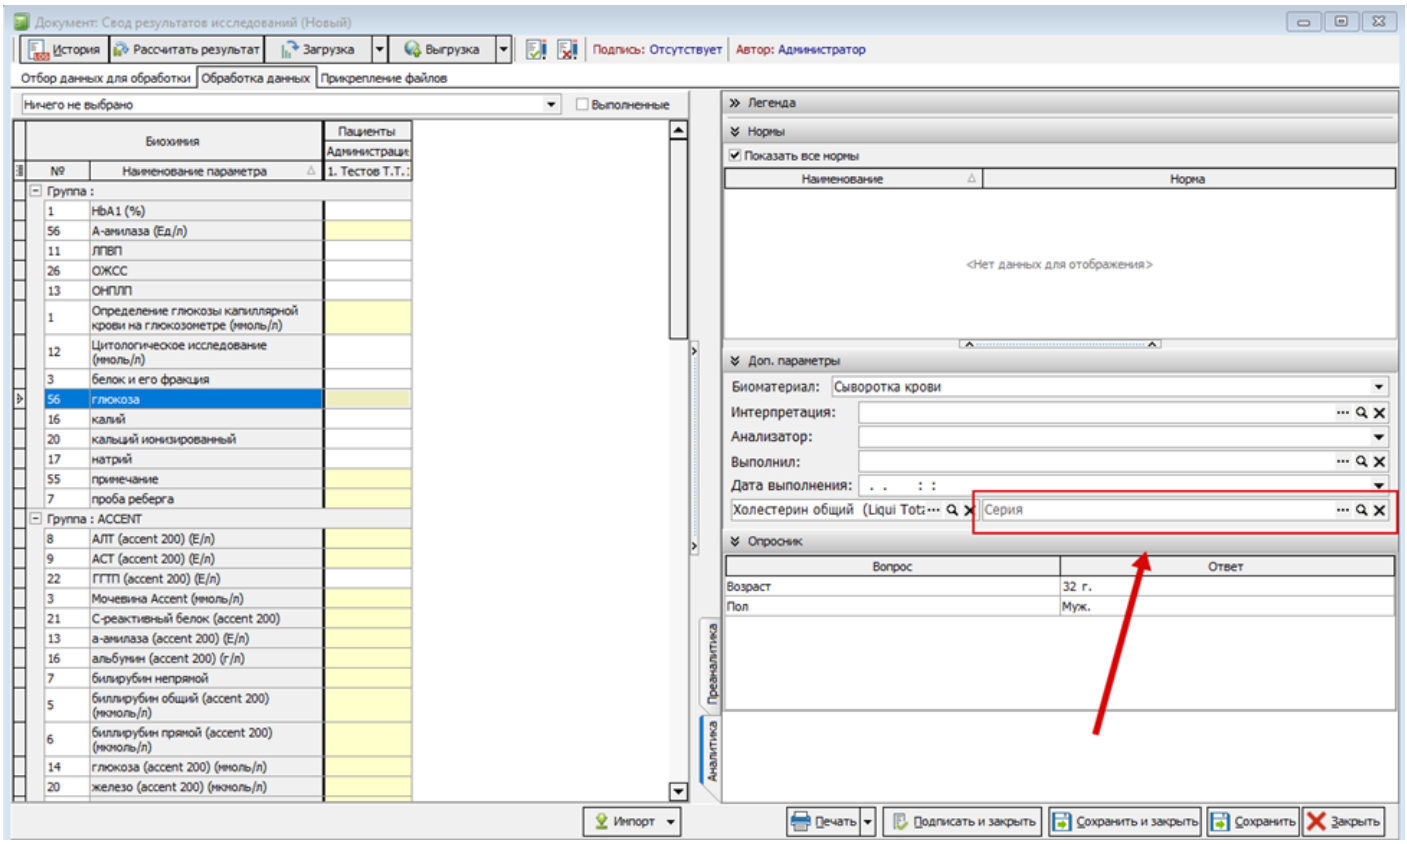


Рисунок 18

Чтобы заполнить реагент и серию в результате, необходимо во вкладке “Необходимые исследования” найти столбцы “Реагент” и “Серия”. (Рисунок 19)

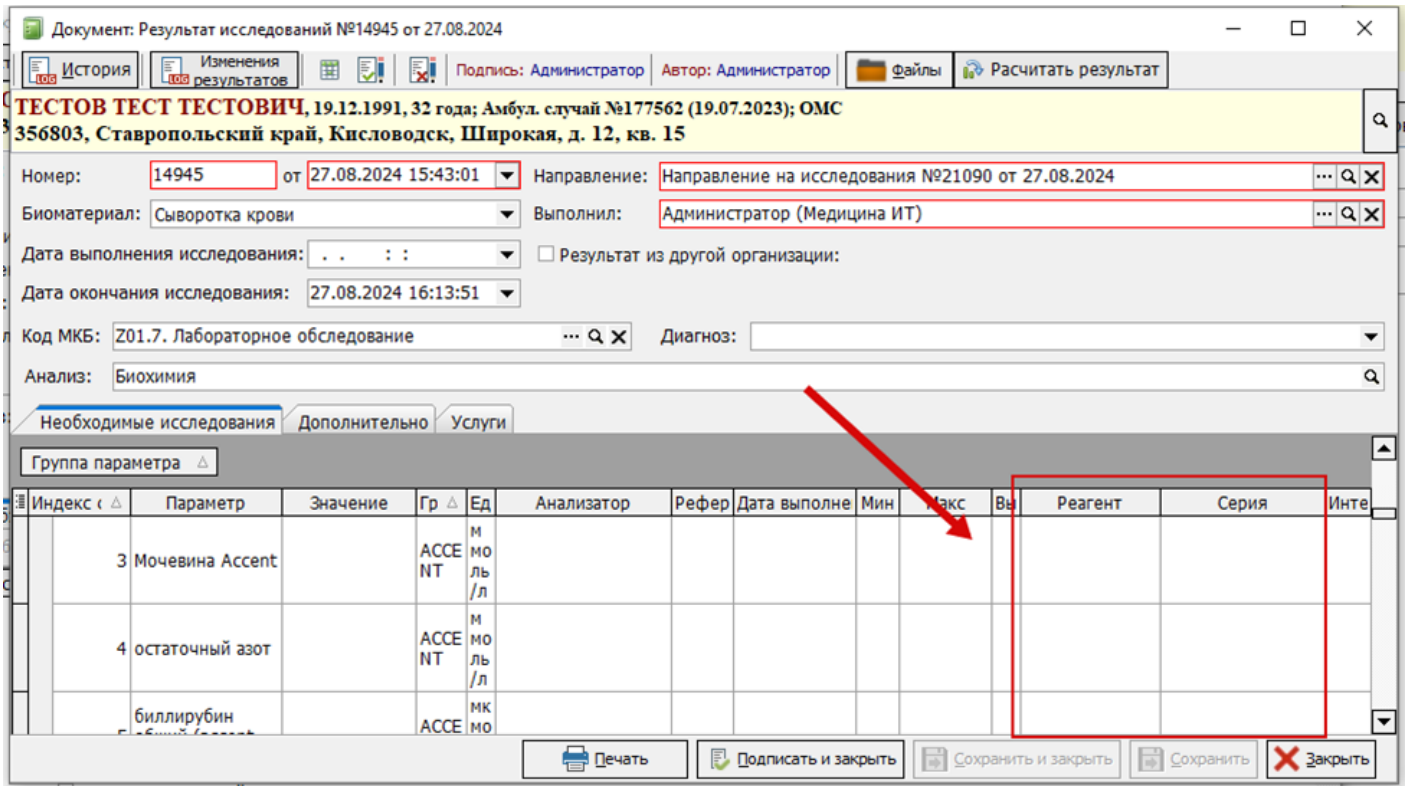


Рисунок 19

Реагент и серия в результате заполняется также, как и в своде. Но если в своде уже были указаны эти данные, то они автоматически подставляются в результат.

Если реагенты не будут заполнены в настройках анализа/исследования, то при заполнении реагентов в своде/результате, справочник будет пустой.

Revision #4
Created 26 December 2024 10:31:51 by Подопригора Дарья
Updated 8 July 2026 09:46:31 by Подопригора Дарья
1 17