1. Настройка работы планшета для подписи

1. Подключение планшета для подписи.

На данный момент реализована интеграция с планшетом для подписи модели Wacom STU-430 (рисунок 1) и с планшетом Signotec delta 10.1 st-dert-3-u100 (рисунок 2).



Рисунок 1.

Image not found or type unknown

Рисунок 2.

На АРМ, с которого будет осуществляться работа с планшетом для подписи необходимо установить драйвера. Как правило драйвера идут в комплекте с планшетом, либо их необходимо скачать с официального сайта производителя планшета.

> * Интеграция с другими моделями планшетов для подписи не входит в договор технической поддержки и оплачивается отдельно. Для получения более подробной информации по данному вопросу рекомендуем обратиться в бухгалтерию ООО "Медицина ИТ" по тел.: (88652) 99-13-50.

2. Настройка планшета для подписи в МИС "КСАМУ".

Для активации функционала подписи через планшет необходимо выбрать пункт меню «ЛПУ» → «Параметры» (рисунок 3).

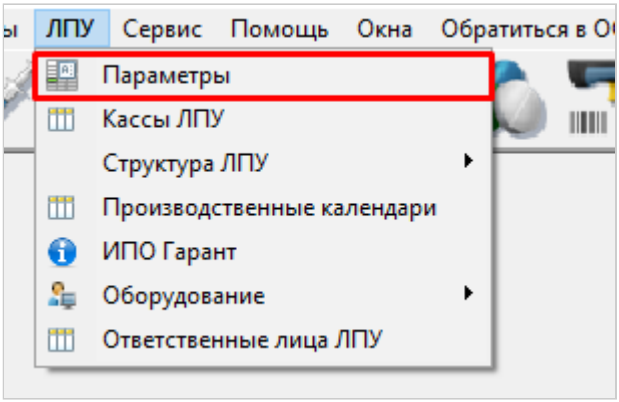


Рисунок 3.

В открывшемся окне перейти на вкладку «Касса/Платные услуги» и активировать настройку «Используется электронная подпись пациента» (рисунок 4).

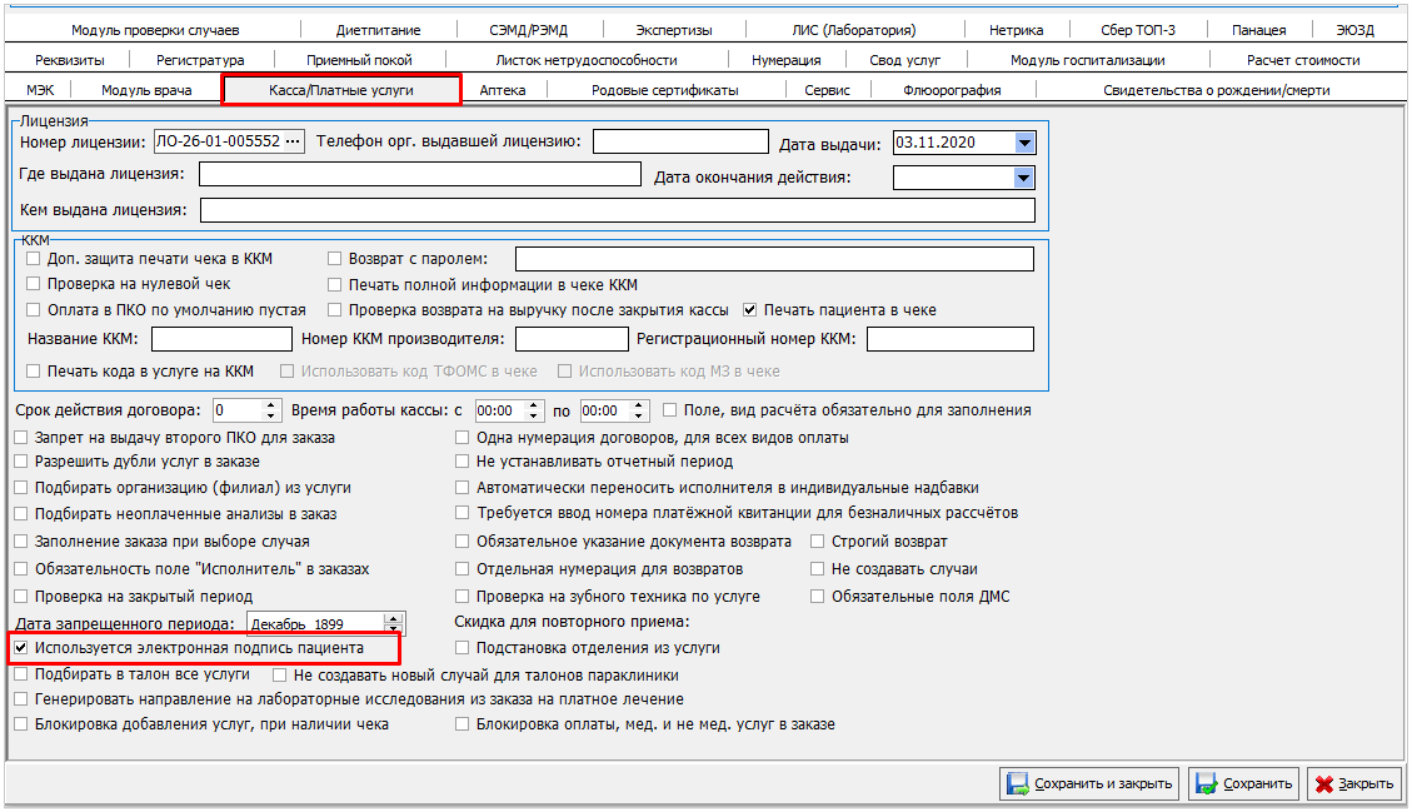


Рисунок 4.

Для корректной работы должны быть установлены библиотеки от производителя.
Wacom-STU-SDK-2.13.4.msi
Wacom-Signature-SDK-x86-3.19.2.msi

Revision #8
Created 26 March 2025 07:45:46 by Ашихина Анастасия
Updated 22 May 2026 06:29:30 by Давлет-Кильдеева Екатерина
1 3
