Настройка автоматической отправки флюорографа

Для пересылки снимков и автоматической записи прохождения флюорографии в базу данных, необходимо указать следующие настройки в аппарате (производится сотрудниками медицинской организации при согласовании с обслуживающим персоналом аппаратов).

DICOM ID: DVTK_STR_SCP

Порт: 105

IP: IP где установлен сервер КСАМУ

В программе пересланные данные можно просмотреть в справочнике «Регистр ЦАМИ» (рисунок 15, рисунок 16).

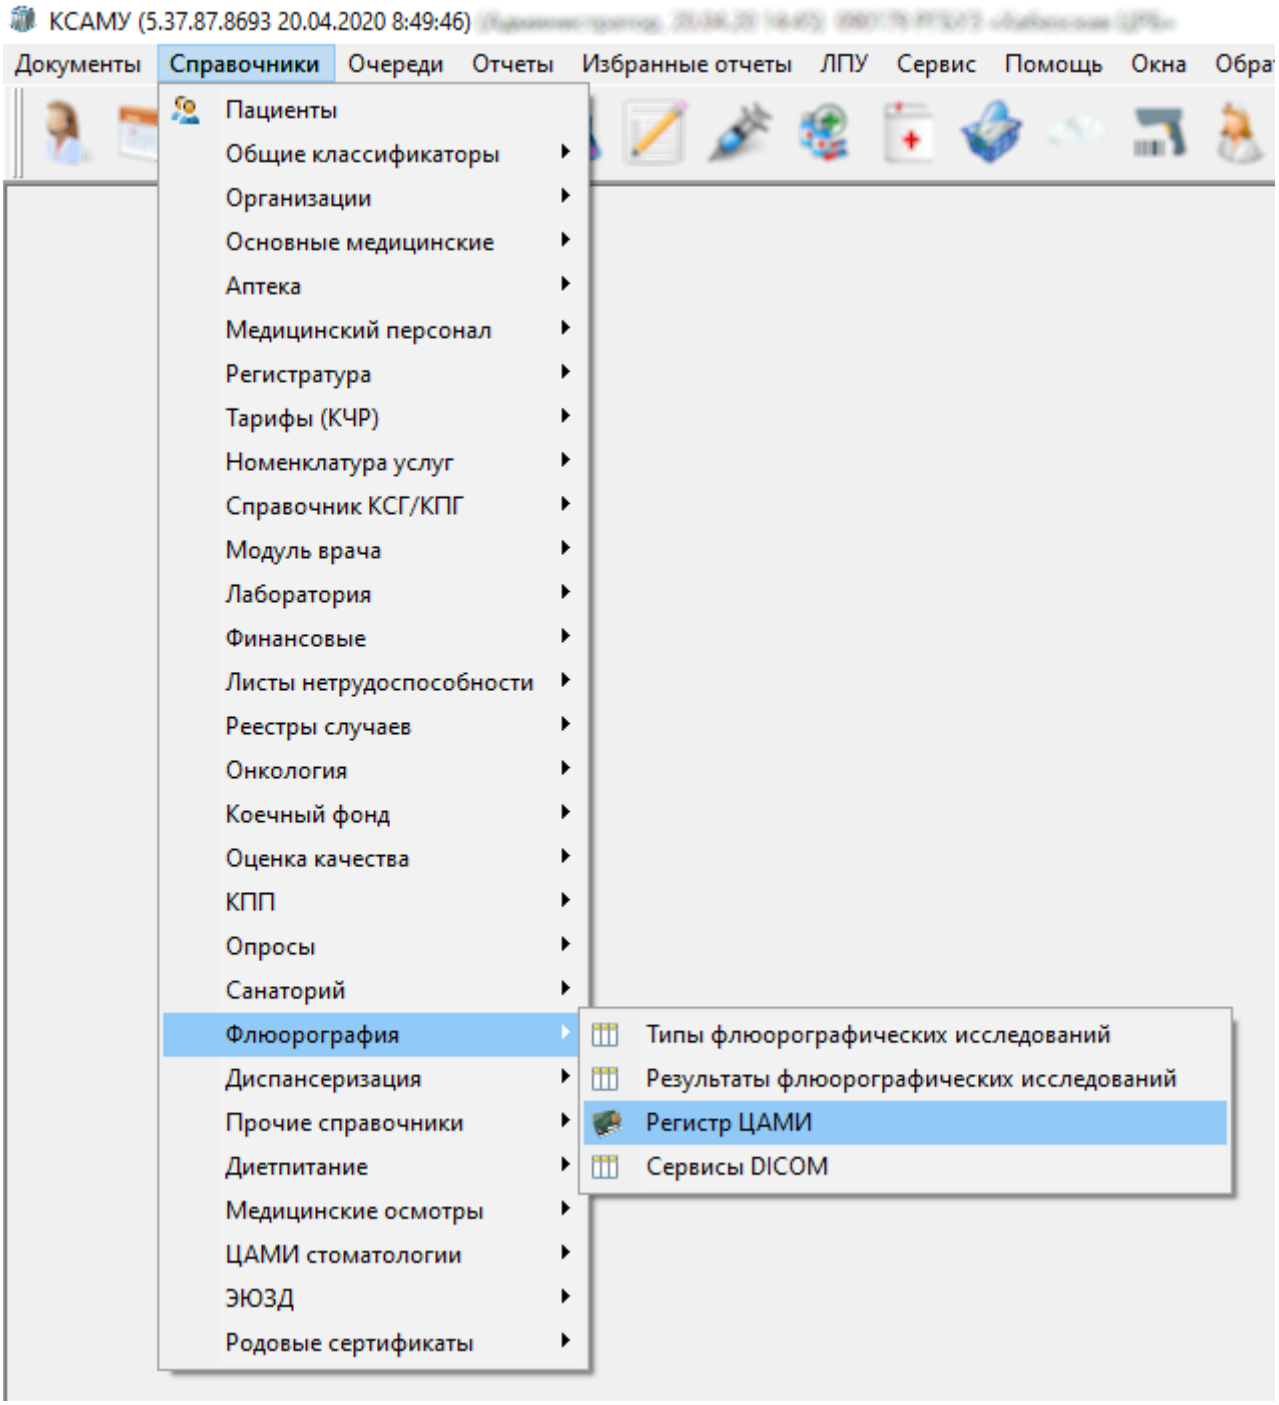


Рисунок 15 – Путь перехода к разделу «Регистр ЦАМИ»

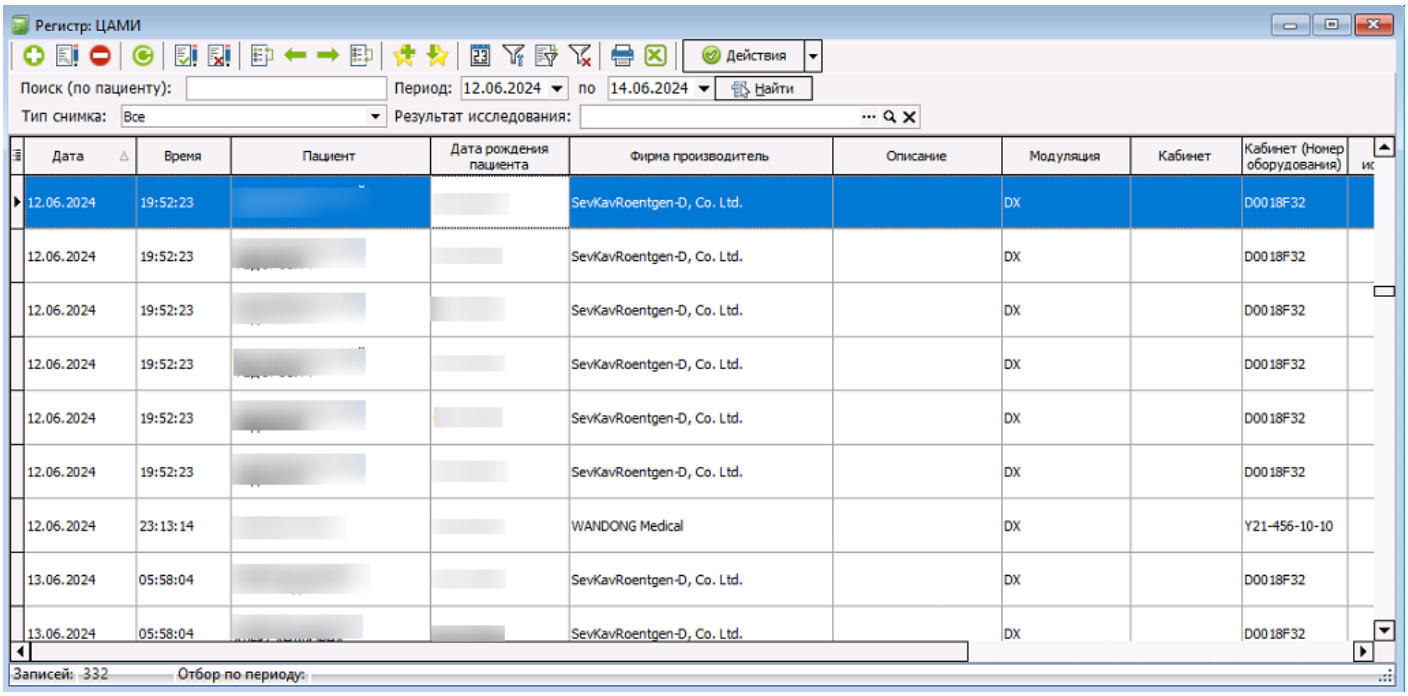


Рисунок 16 – Окно «Регистр: ЦАМИ»

Revision #4
Created 14 June 2024 07:04:21 by Навасардян Валерия
Updated 14 June 2024 07:17:18 by Навасардян Валерия

1 3